

B · R · A · H · M · S


**PCT**  
ADVIA Centaur® Systems

**Immunodosage par chimiluminescence (CLIA) pour la mesure de la PCT (Procalcitonine) dans le serum ou le plasma humain sur les immuno-analyseurs ADVIA Centaur® XP et ADVIA Centaur® CP**


**Caractéristiques**

- Dosage en chimiluminescence en une étape utilisant trois anticorps monoclonaux (technique sandwich)
- Echantillons : Serum, plasma (hépariné, EDTA)
- Volume d'échantillon : 100 µL
- Durée d'incubation : 26 min (Centaur® CP) / 29 min (Centaur® XP)
- Gamme de mesure : 0,02-75,00 ng/mL
- Sensibilité fonctionnelle : <0,05 ng/mL
- Sensibilité analytique : <0,02 ng/mL

**Corrélation entre B-R-A-H-M-S PCT sensitive KRYPTOR et ADVIA Centaur® B-R-A-H-M-S PCT mesuré sur l'automate ADVIA Centaur® XP**

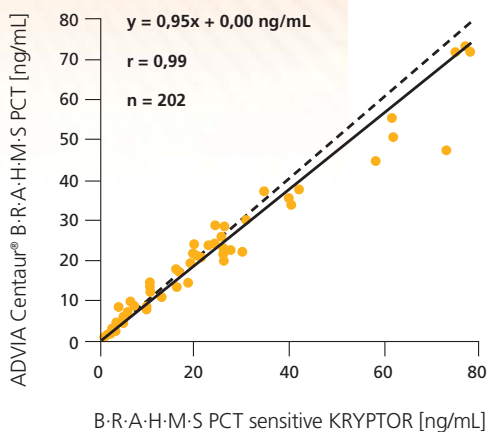


**Corrélation entre B-R-A-H-M-S PCT sensitive KRYPTOR et ADVIA Centaur® B-R-A-H-M-S PCT mesuré sur l'automate ADVIA Centaur® CP**



Protégée par les brevets suivants :  
 USA N° 5 639 617, N° 5 541 116; Europe N° 0 656 121, N° 0 559 853,  
 N° 0 880 702, N° 0 659 158; Allemagne N° 41 32 587, N° 42 30 032,  
 N° 196 00 875; Japon N° 257 796, N° 3 095 784; Australie N° 686 114;  
 Chine N° ZL 93 1 18343X; Russie N° 2 137 130;  
 Afrique du sud N° 93/6042

**Corrélation entre B·R·A·H·M·S PCT LIA et ADVIA Centaur® B·R·A·H·M·S PCT mesuré sur l'automate ADVIA Centaur® XP**

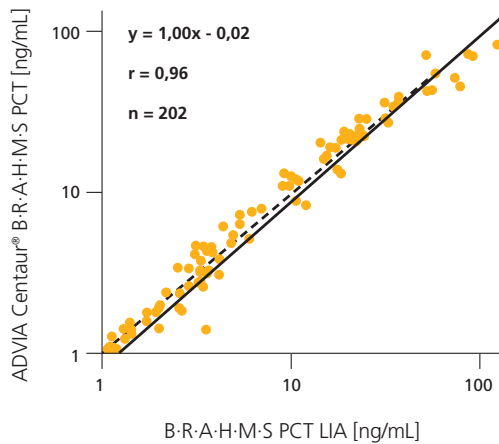

**Précision**

Concentration PCT [ng/mL]	Total CV (%)
0,05-0,1 ng/mL	<11%
0,1-5 ng/mL	<8%
>5 ng/mL	<8%

**Kits disponibles**

**ADVIA Centaur® B·R·A·H·M·S PCT** pour 100 dosages  
Le kit inclut 2 calibrateurs

No. de référence 10378883

**ADVIA Centaur® B·R·A·H·M·S PCT-QC**

No. de référence 10378884

Ce réactif a été développé par Siemens Healthcare Diagnostics en collaboration avec B·R·A·H·M·S Aktiengesellschaft.

**La distribution du kit ADVIA Centaur® B·R·A·H·M·S PCT est assurée par B·R·A·H·M·S** en Autriche, Benelux, France, Allemagne, Italie, Scandinavie, Espagne, Suisse, Grande-Bretagne. Elle est assurée **par SIEMENS Healthcare Diagnostics** dans tous les autres pays.

ADVIA Centaur® est une marque protégée et appartient à Siemens Healthcare Diagnostics.

B·R·A·H·M·S PCT est une marque déposée par le groupe B·R·A·H·M·S Aktiengesellschaft.

